


01 / Seitenwand der Bügeltasche

Schnittkante: 340 × 230 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die oberen 18 mm sind für den Rahmenansatz vorgesehen. Kontur und Lochung vor dem Zuschnitt am tatsächlichen Rahmen präzisieren.

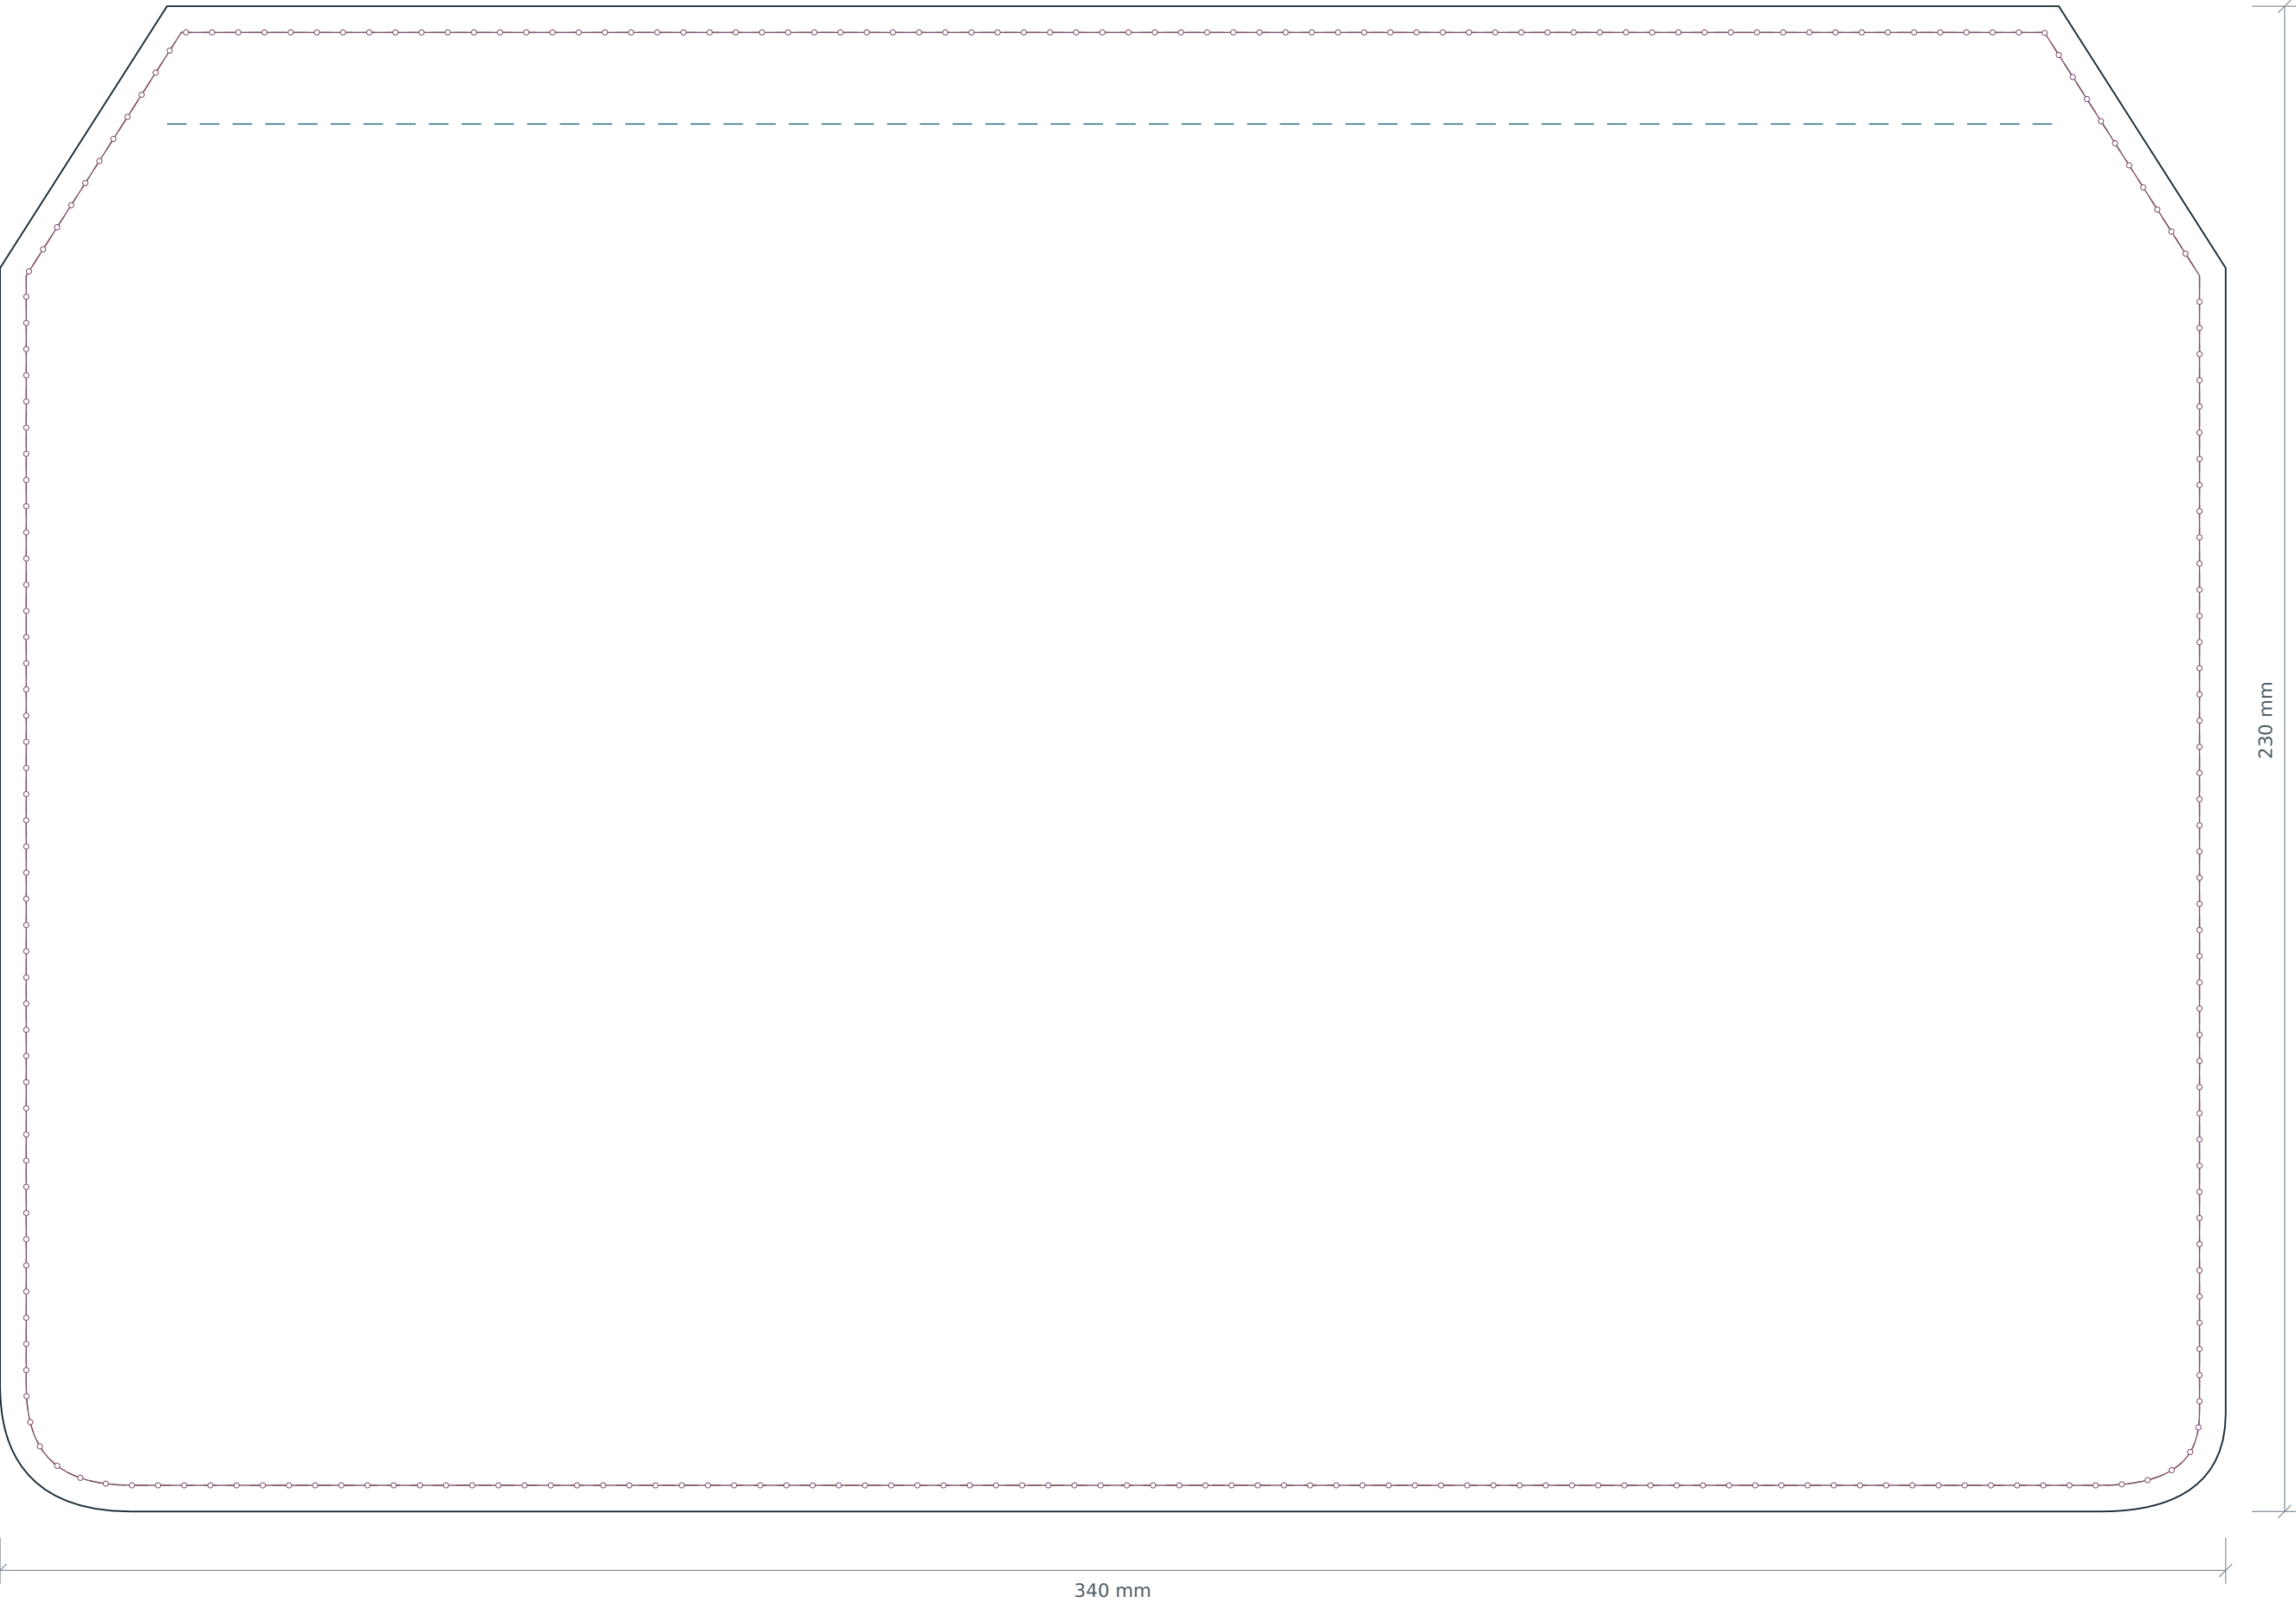

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 394 × 326 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.


02 / Seitenwand der Bügeltasche

Schnittkante: 340 × 230 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Die oberen 18 mm sind für den Rahmenansatz vorgesehen. Kontur und Lochung vor dem Zuschnitt am tatsächlichen Rahmen präzisieren.

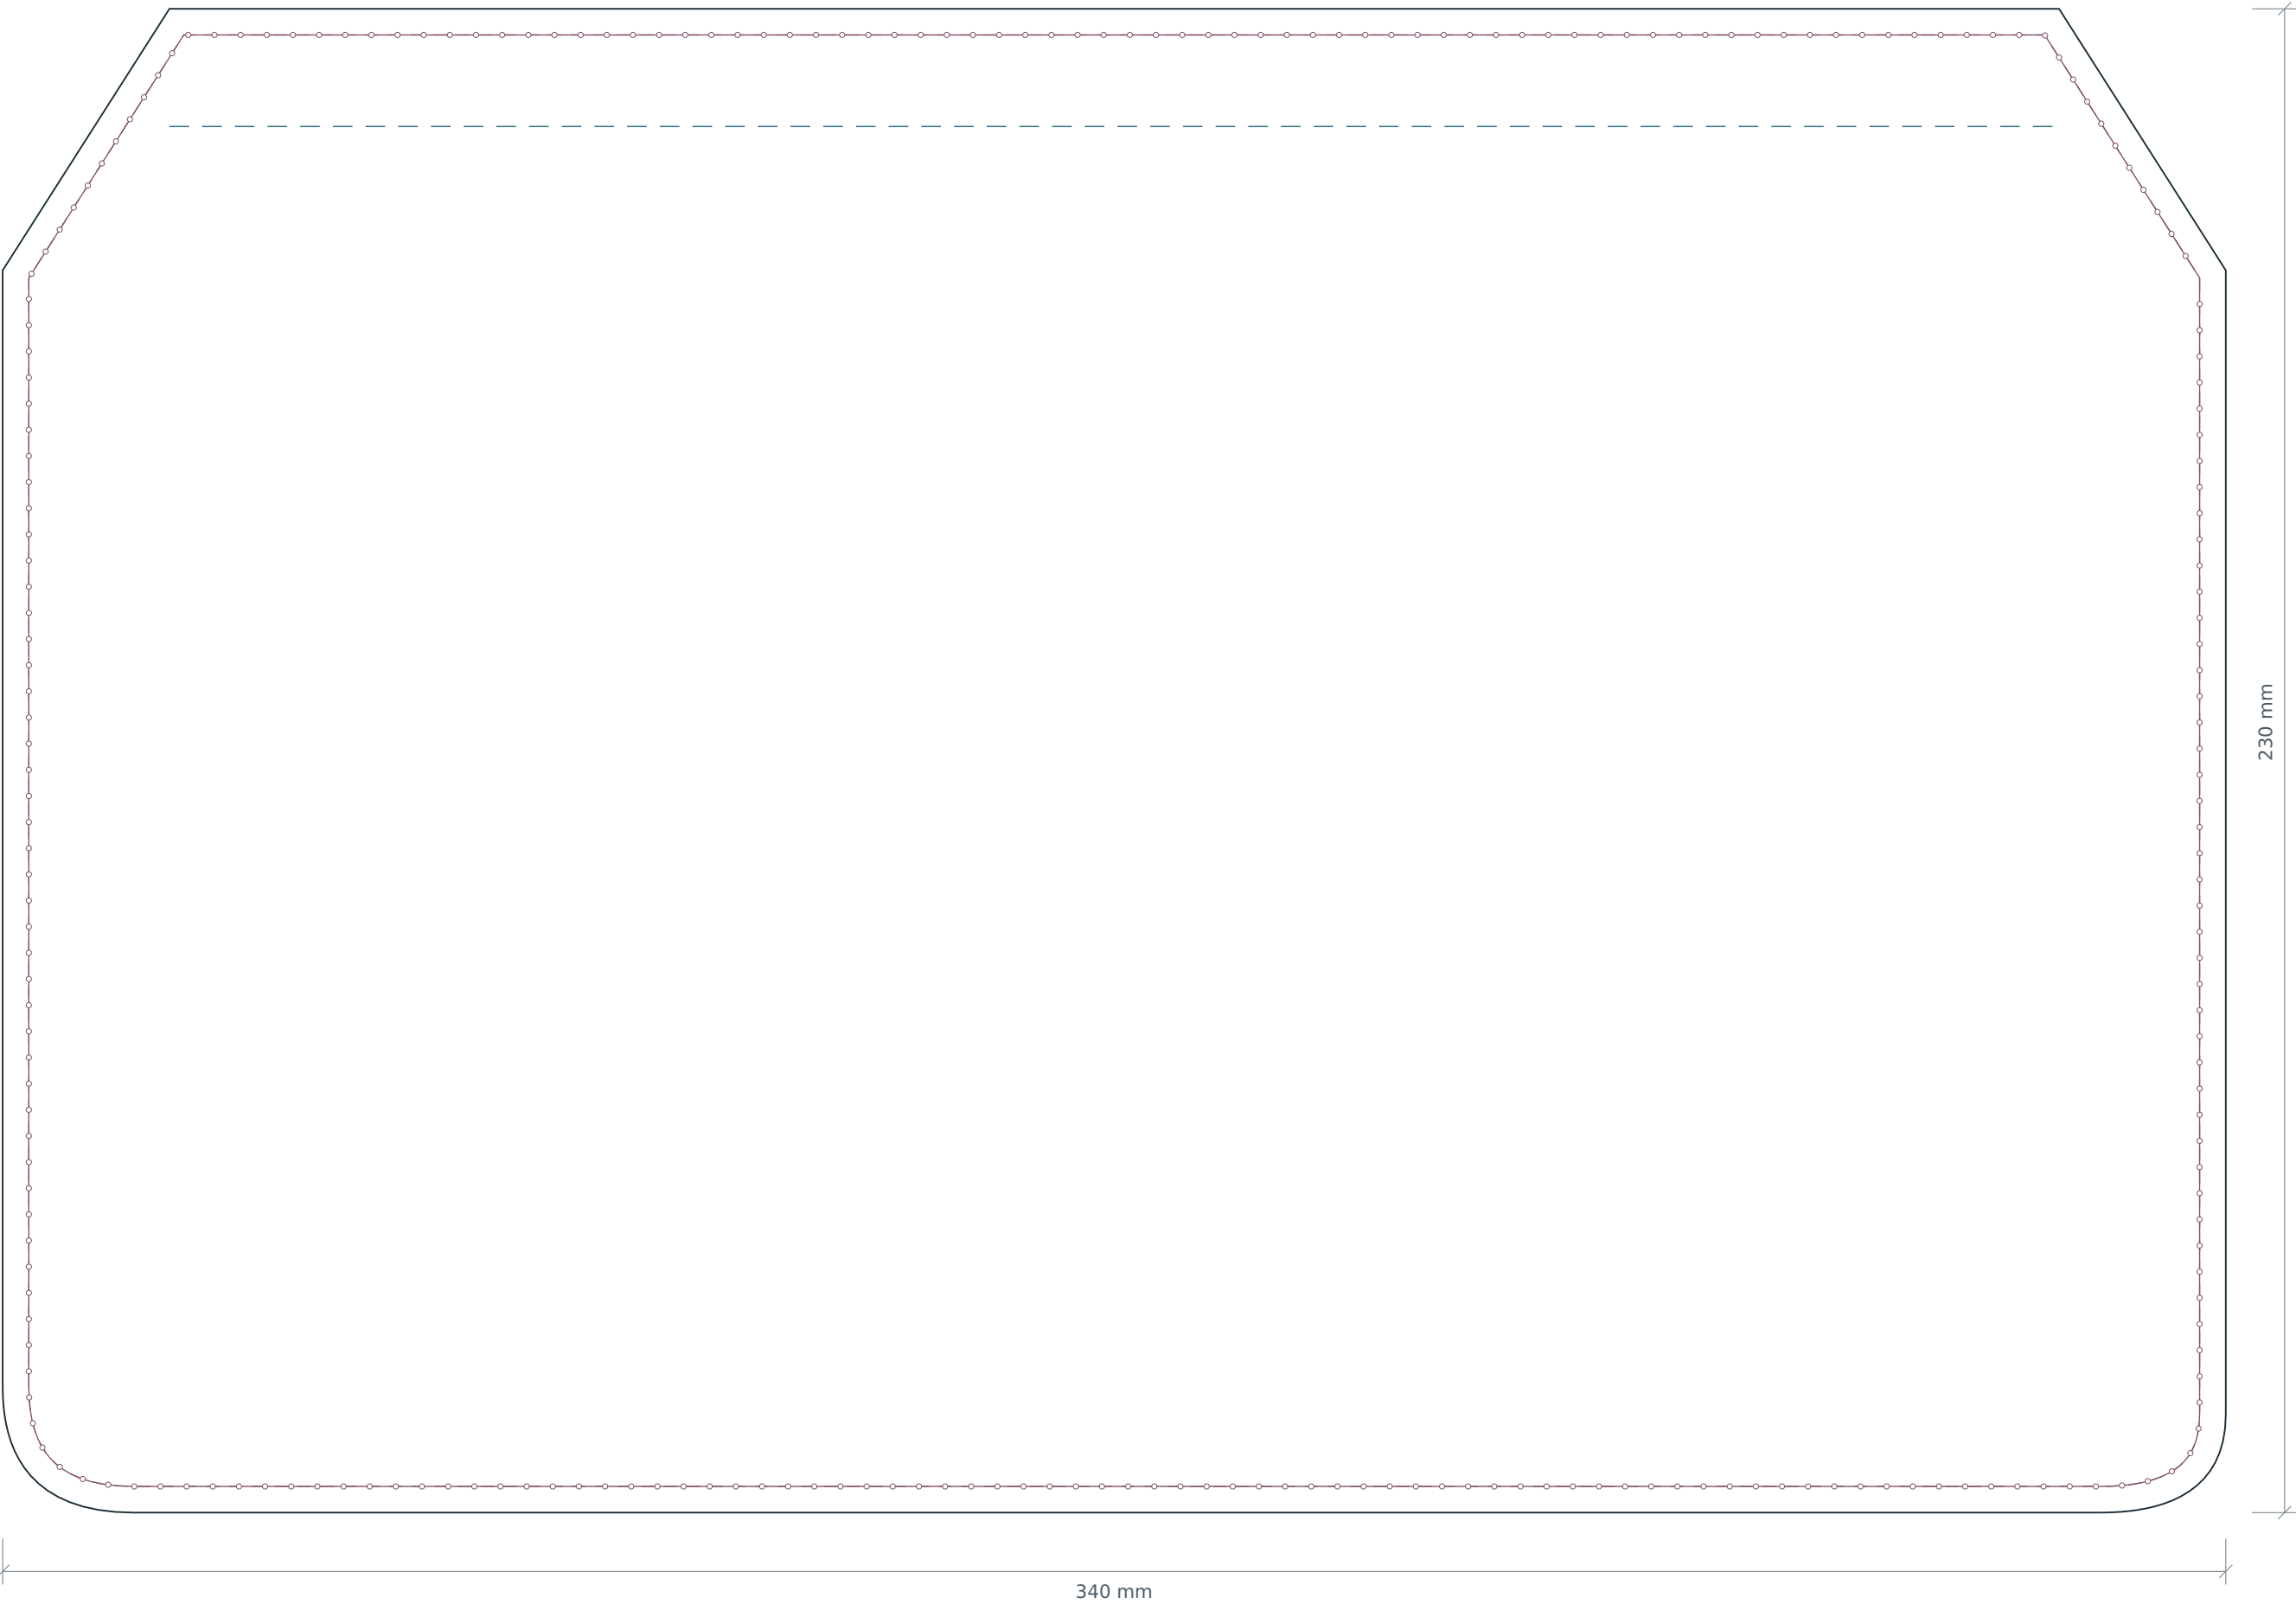

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 394 × 326 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/doctor-frame/


Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Schnittkante: 801 × 156 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 340 × 230 × 150 mm. Zwei Seitenwände, zur Rahmenkante hin verjüngt, eine durchgehende untere Seitenwand und zwei Henkel. Zugekaufter Rahmen mit einer Breite von etwa 290 mm: Die Passform der oberen Kante unbedingt auf die ausgewählte Hardware übertragen.

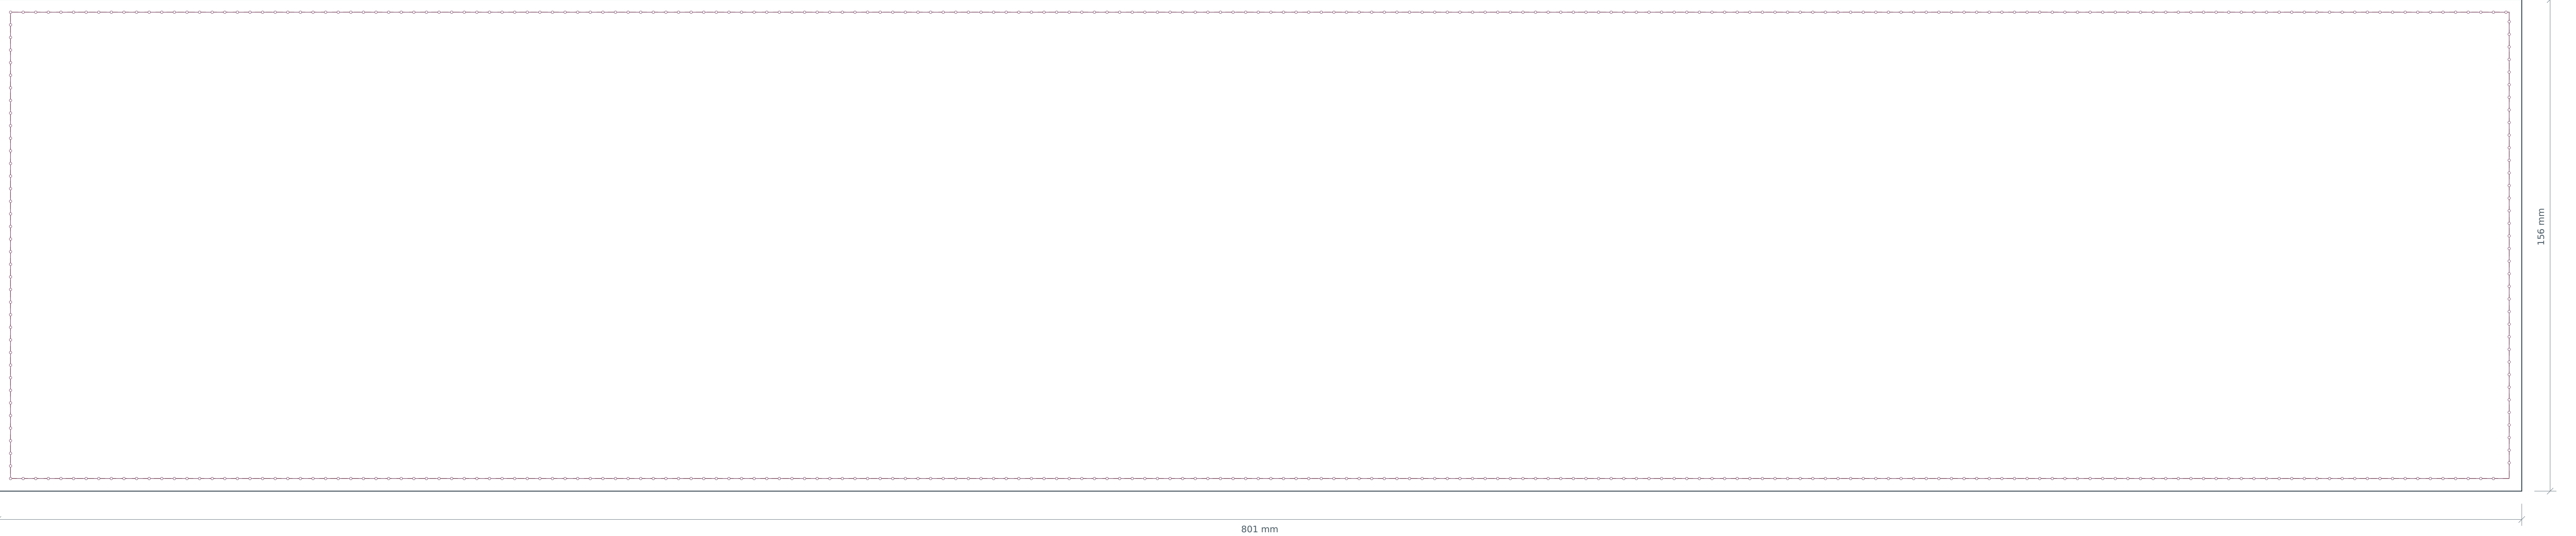

Maßstabskontrolle: 100 mm

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 855 × 252 mm.

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

VLOTHO / CAD


04 / Henkel · handle--1

Schnittkante: 420 × 22 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 340 × 230 × 150 mm. Zwei Seitenwände, zur Rahmenkante hin verjüngt, eine durchgehende untere Seitenwand und zwei Henkel. Zugekaufter Rahmen mit einer Breite von etwa 290 mm: Die Passform der oberen Kante unbedingt auf die ausgewählte Hardware übertragen.

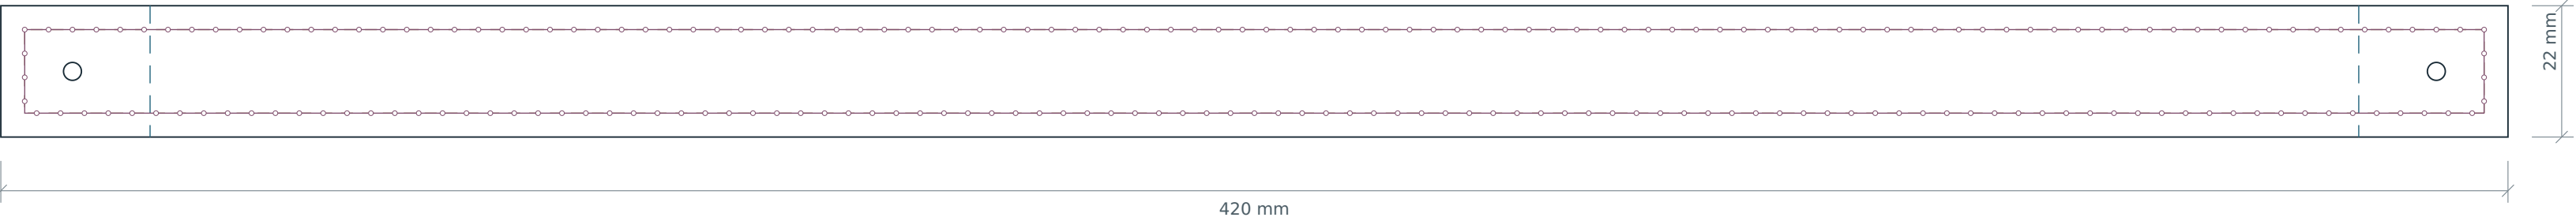

Maßstabskontrolle: 100 mm



Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 474 × 160 mm.


05 / Henkel · handle-1

Schnittkante: 420 × 22 mm | Nahtzugabe: 0 mm | 1 Teil.

Maßstab 1:1. Durchgezogene Linie - Schnittkante, gestrichelt - nahtlinie, blaue Striche - Markierungen.

Handnaht · Abstand 4 mm · Löcher Ø 0.8 mm

Testmaße 340 × 230 × 150 mm. Zwei Seitenwände, zur Rahmenkante hin verjüngt, eine durchgehende untere Seitenwand und zwei Henkel. Zugekaufter Rahmen mit einer Breite von etwa 290 mm: Die Passform der oberen Kante unbedingt auf die ausgewählte Hardware übertragen.

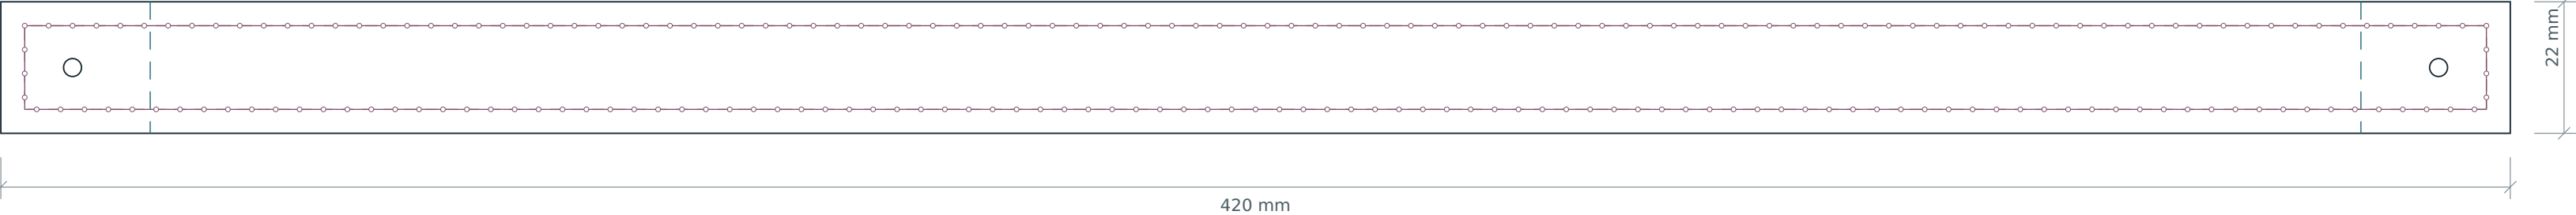

Maßstabskontrolle: 100 mm

Parameter und Aktualisierungen: vlotho-farben.com/de/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: Anpassungen für Falten und Materialstärke sind nicht enthalten.

Drucken: 100 %, tatsächliche Größe.

Seite: 474 × 160 mm.