


01 / Ścianka sakwojaża

Przekrój: 340 × 230 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Górne 18 mm — osadzenie ramki. Kontur i układ otworów doprecyzować według rzeczywistej ramki przed rozkrojem.

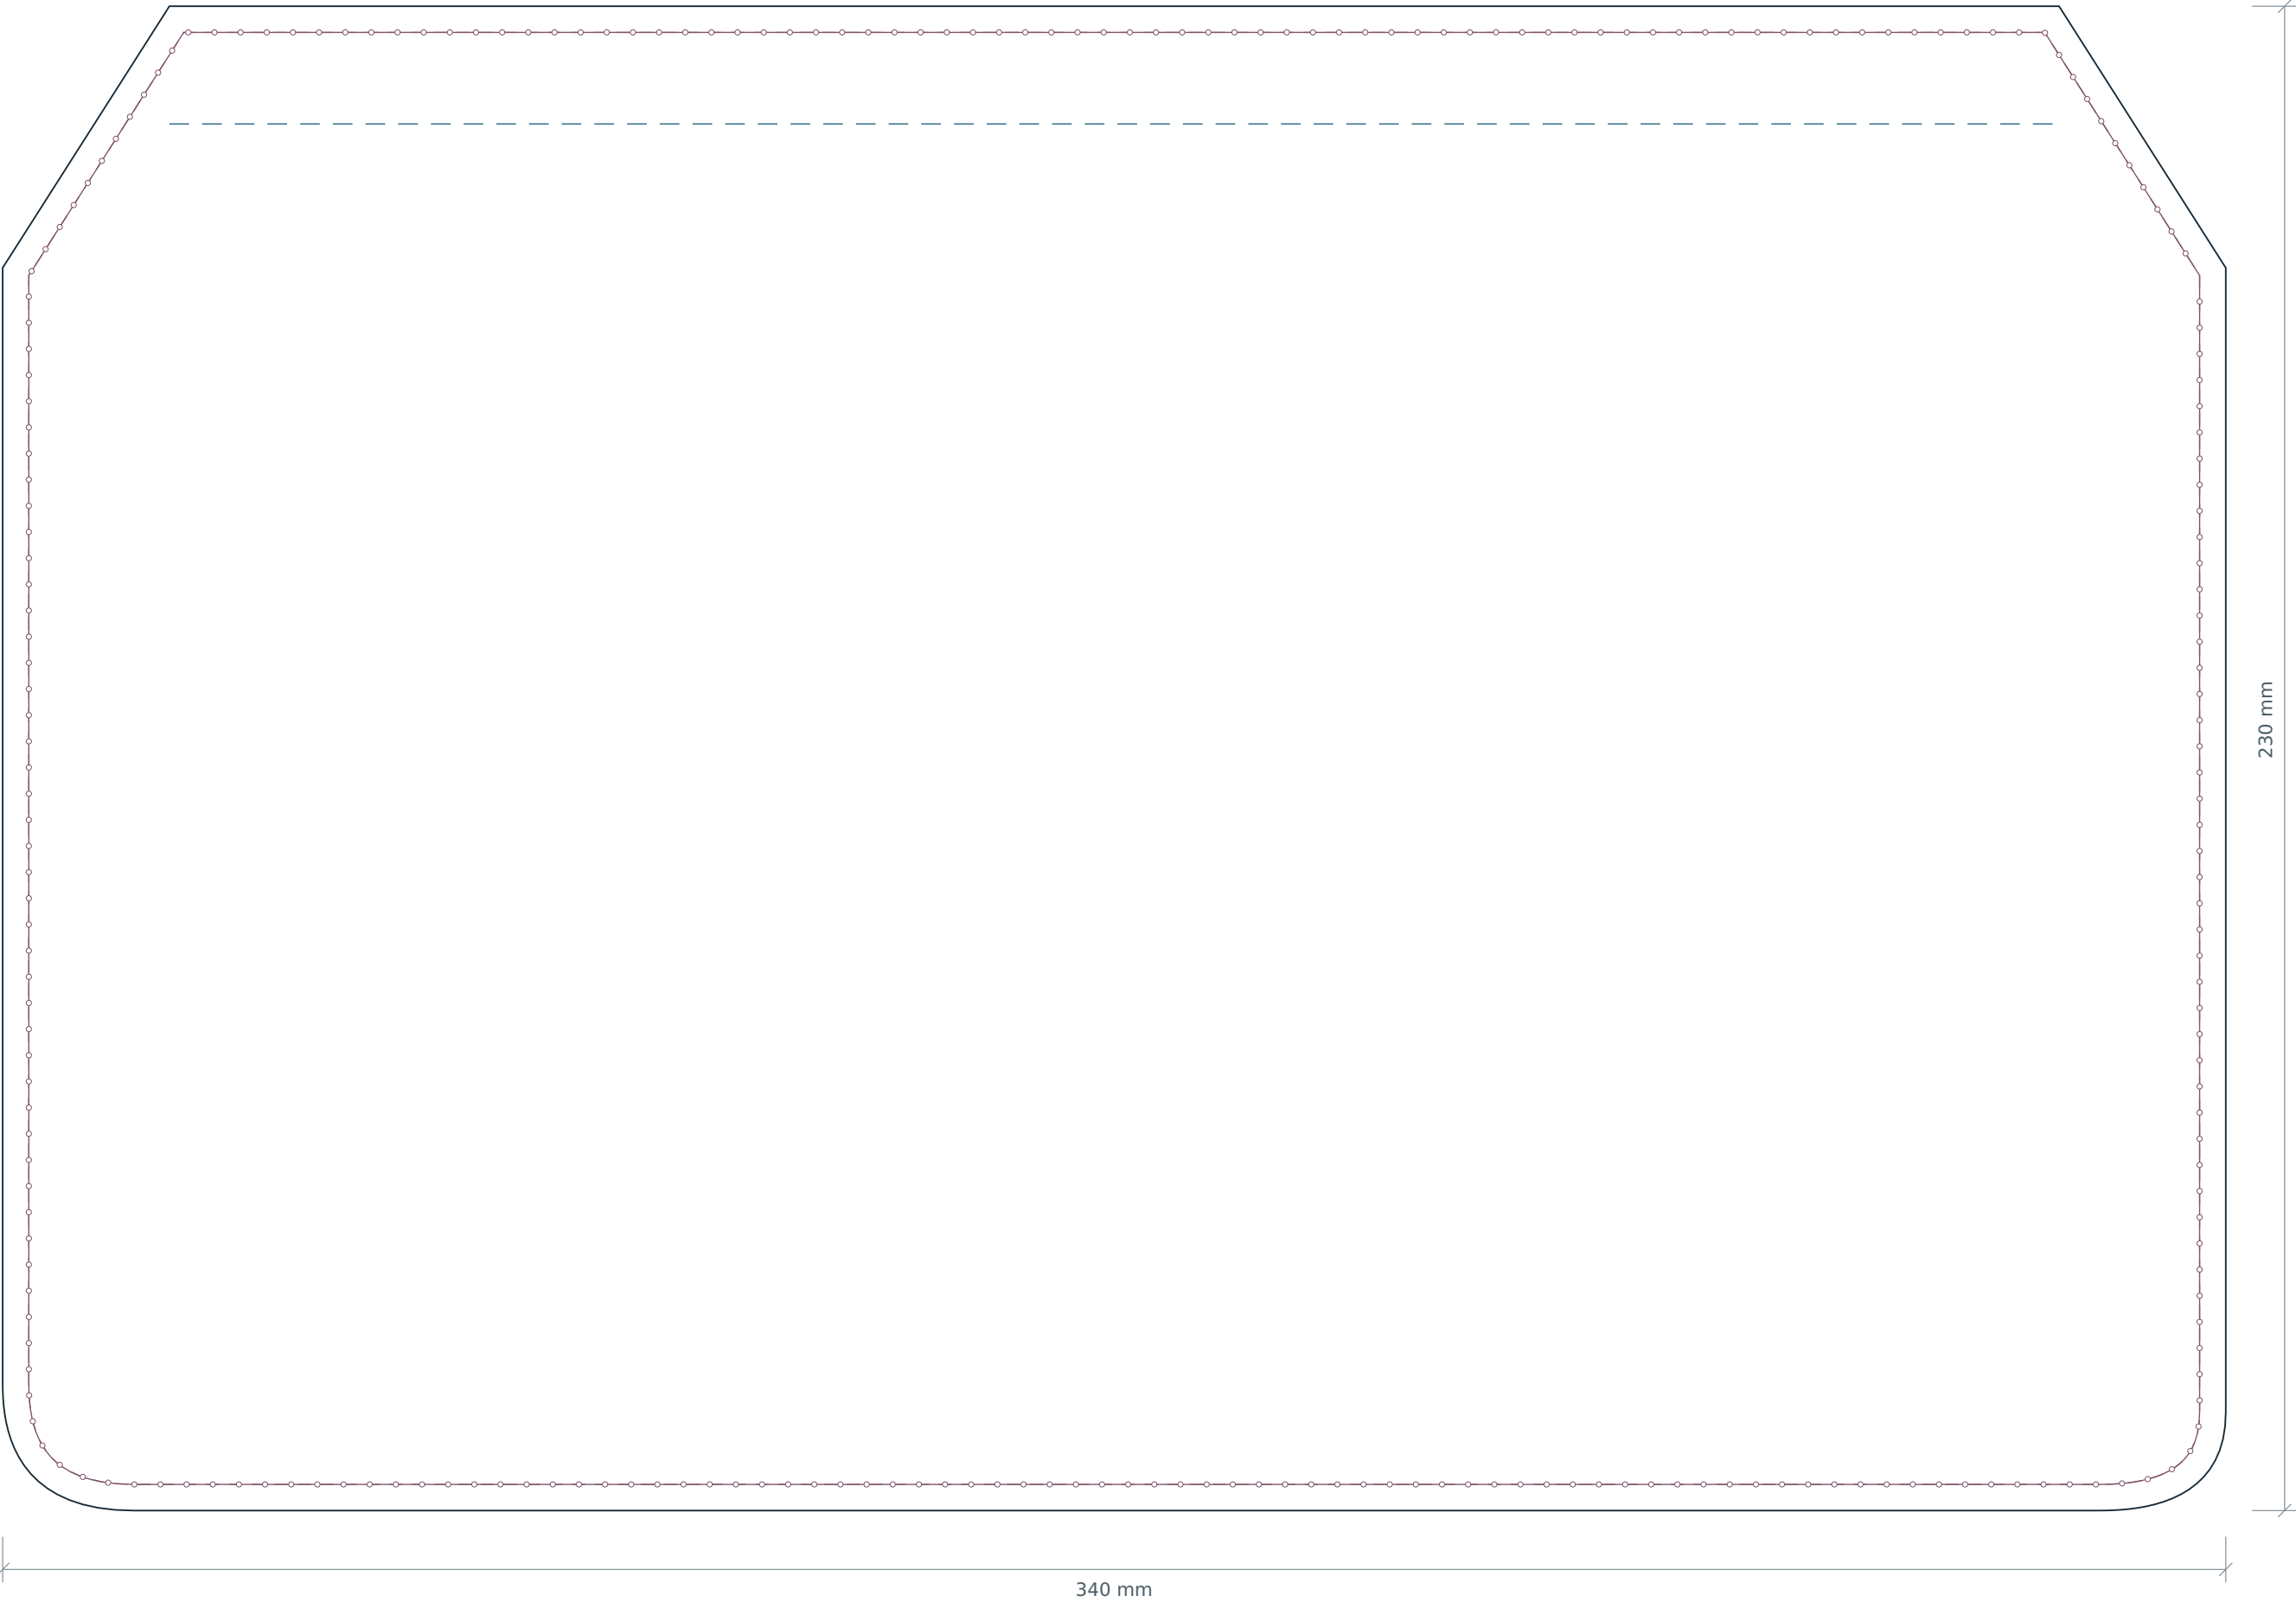

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 394 × 326 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


02 / Ścianka sakwojaża

Przekrój: 340 × 230 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Górne 18 mm — osadzenie ramki. Kontur i układ otworów doprecyzować według rzeczywistej ramki przed rozkrojem.

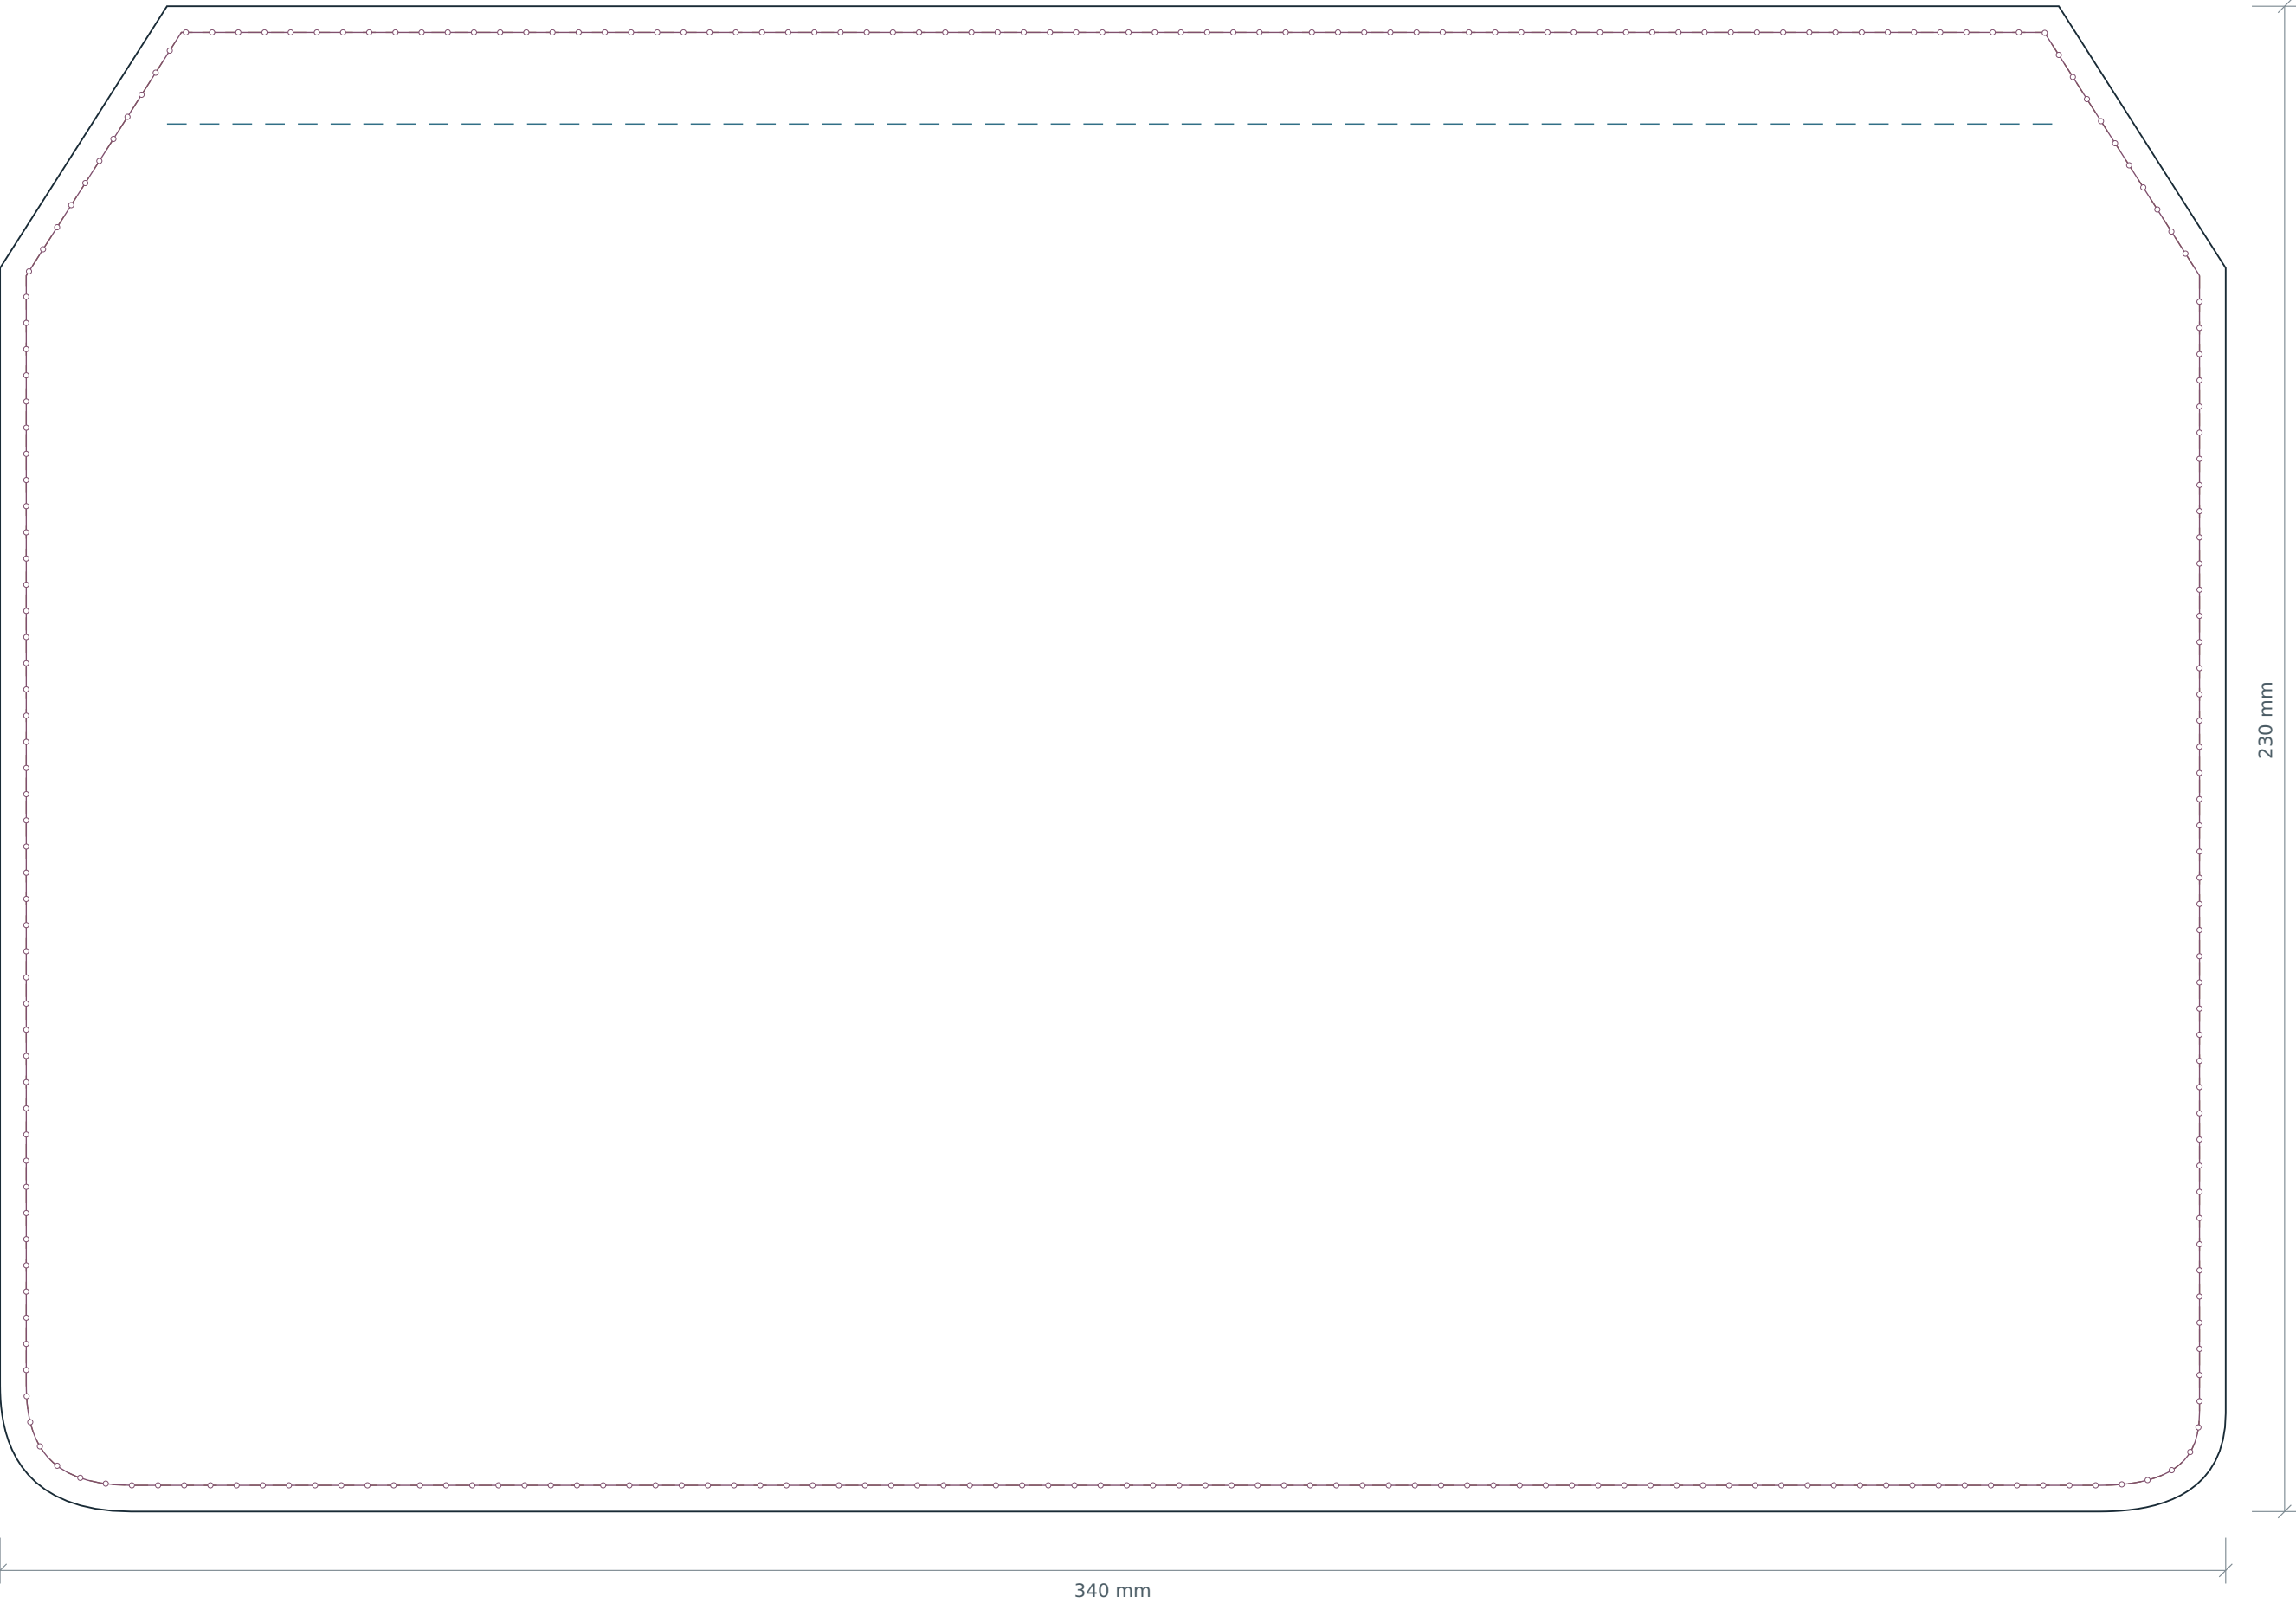

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 394 × 326 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


03 / Bok i dno

Przekrój: 801 × 156 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 340 × 230 × 150 mm. Dwie ścianki zwiężające się ku ramie, ciągła dolna ścianka boczna i dwa uchwyty. Kupowana rama o szerokości około 290 mm: dopasowanie górnej krawędzi koniecznie przenieść z wybranych okuć.

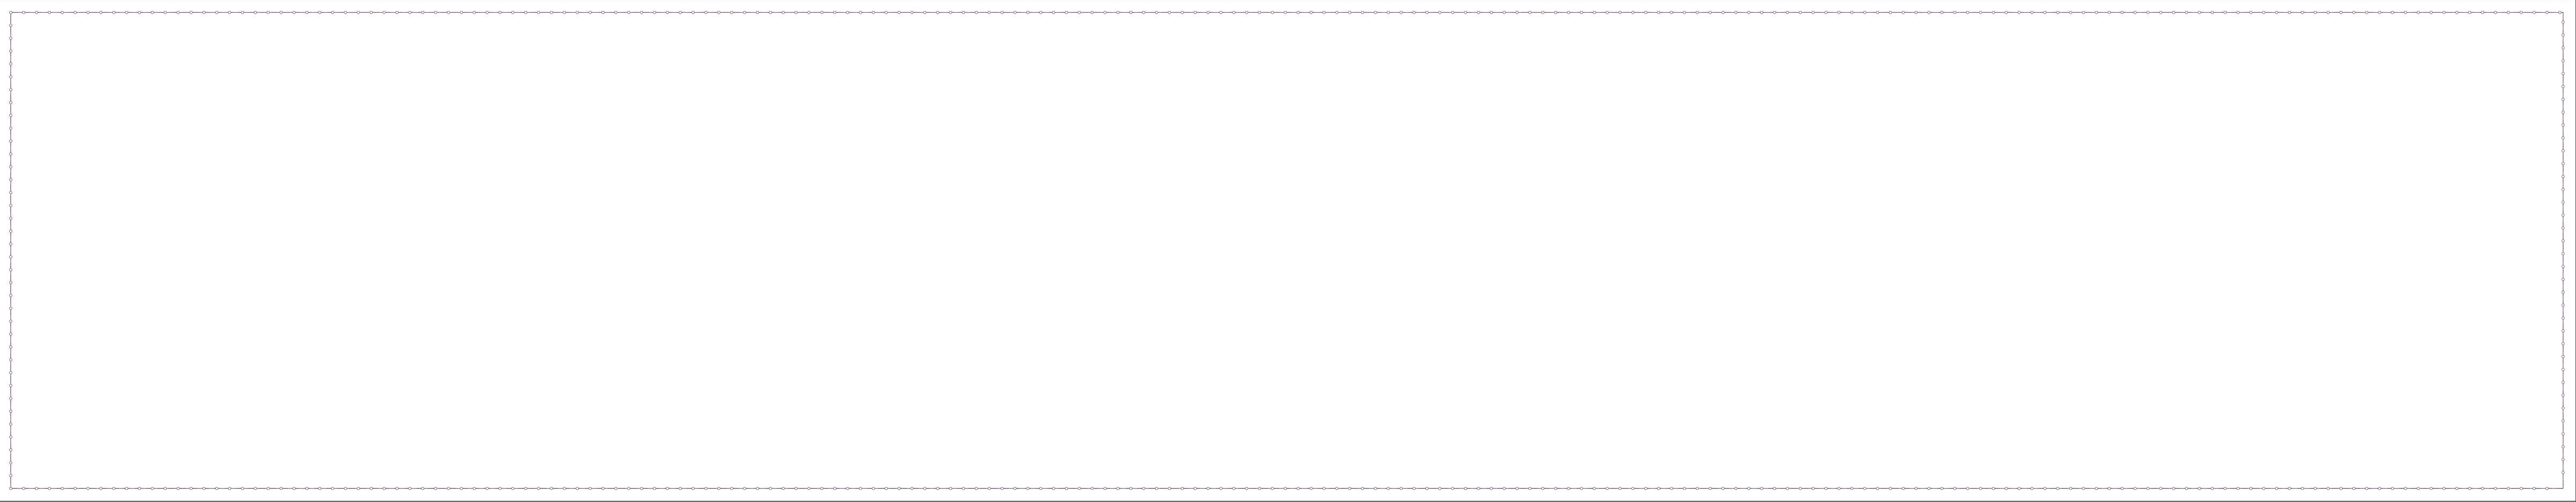

801 mm

156 mm

Kontrola skali: 100 mm

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 855 × 252 mm.

Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.


04 / Rączka · handle--1

Przekrój: 420 × 22 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 340 × 230 × 150 mm. Dwie ścianki zwężające się ku ramie, ciągła dolna ścianka boczna i dwa uchwyty. Kupowana rama o szerokości około 290 mm: dopasowanie górnej krawędzi koniecznie przenieść z wybranych okuć.

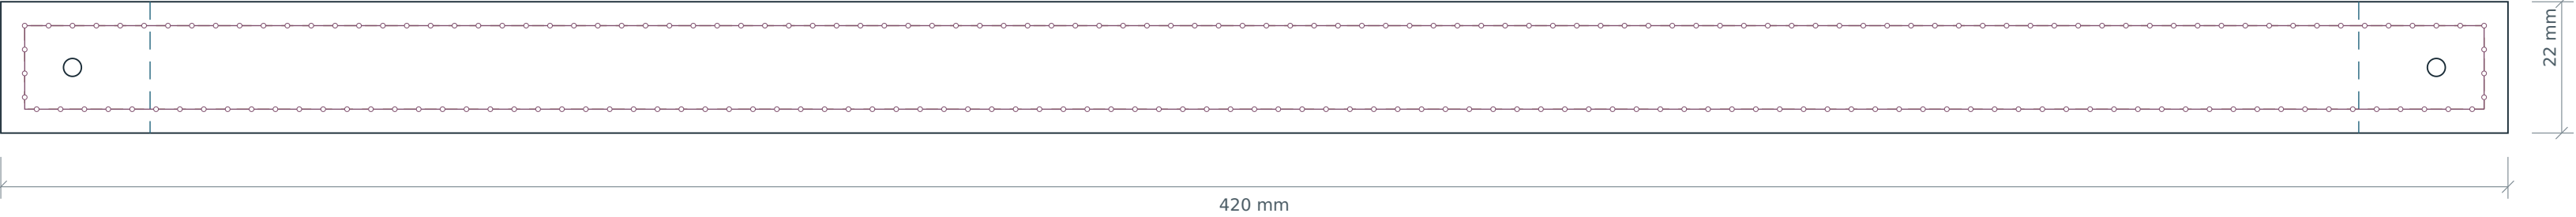

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 474 × 160 mm.


05 / Rączka · handle-1

Przekrój: 420 × 22 mm | Zapas: 0 mm | 1 elem.

Skala 1:1. Linia ciągła - krawędź cięcia, linia przerywana - linia szwu, niebieskie kreski - znaczniki.

Ścieg ręczny · Rozstaw 4 mm · otwory Ø 0.8 mm

Wymiary próbne 340 × 230 × 150 mm. Dwie ścianki zwężające się ku ramie, ciągła dolna ścianka boczna i dwa uchwyty. Kupowana rama o szerokości około 290 mm: dopasowanie górnej krawędzi koniecznie przenieść z wybranych okuć.

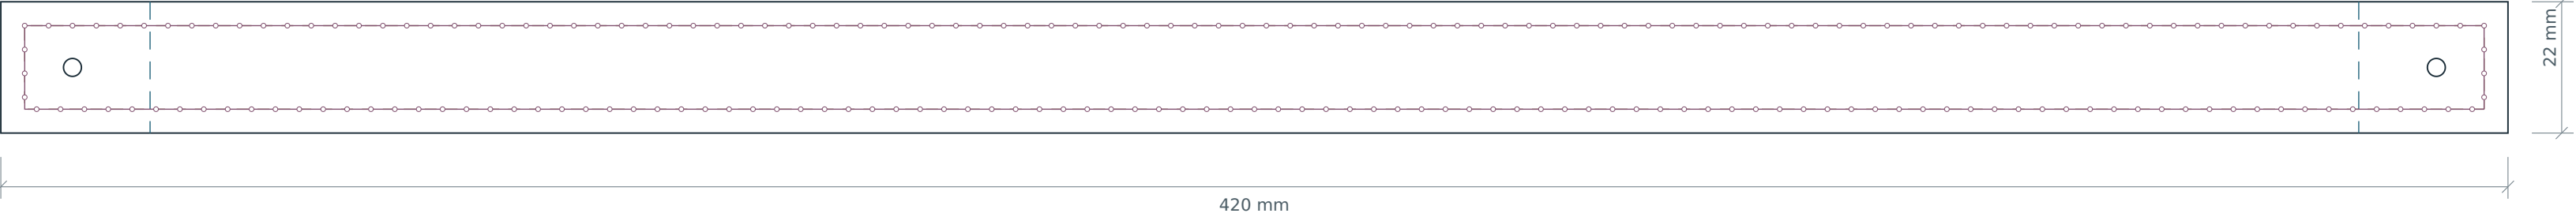

Kontrola skali: 100 mm



Parametry i aktualizacje: vlotho-farben.com/pl/cad/models/doctor-frame/

Prototyp: poprawki na zgięcie i grubość nie zostały uwzględnione.

Drukuj: 100%, rzeczywisty rozmiar.

Strona: 474 × 160 mm.